


DIAGNOSTIC®


**PRO MESH**

INHALATOR SIATECZKOWY

## INSTRUKCJA UŻYCIA

---

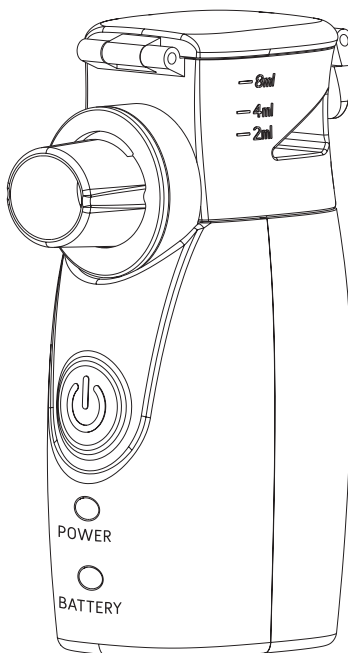

 Diagnosis S.A.  
ul. Gen. W. Andersa 38A  
15-113 Białystok, Polska  
[www.diagnosis.pl](http://www.diagnosis.pl)

**CE** 0197

**REF** 7020

Rev. 2022.06.15

## SPIS TREŚCI

Środki bezpieczeństwa.....	2
Cechy produktu.....	3
Opis elementów zestawu .....	4
Jak złożyć inhalator.....	4
Jak podłączyć do źródła zasilania .....	5
Jak napełnić urządzenie lekiem.....	6
Jak obsługiwać inhalator.....	7
Czyszczenie i dezynfekcja .....	8
Jak wymienić pojemnik na lek .....	10
Jak przechowywać inhalator i akcesoria .....	11
Rozwiązywanie problemów.....	12
Specyfikacja techniczna .....	15
Wykaz wielkości cząsteczek rozpylanych przez inhalator.....	16
Akcesoria / części wymienne .....	16
Wyjaśnienie symboli .....	17
Kompatybilność elektromagnetyczna .....	17

## Szanowny Kliencie

Dziękujemy za zakup inhalatora Diagnostic PRO MESH. Dla właściwego użytkowania inhalatora jak i uzyskania najlepszej skuteczności jego działania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użycia. Należy zachować instrukcję użycia, aby móc skorzystać z niej w razie potrzeby.

### Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez personel służby zdrowia, jak również przez pacjentów w domu po otrzymaniu od lekarza dokładnej instrukcji dawkowania leku. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się ze sposobem działania urządzenia i treścią instrukcji użycia.

Wyrób przeznaczony jest do inhalacji, do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych. Umożliwia natychmiastowe i bezpośrednie dotarcie preparatu medycznego w formie wziewnej do oskrzeli i płuc.

Inhalatora nie wolno stosować niezgodnie z jego przeznaczeniem.

### Użytkownik docelowy

Pacjenci dorośli i dzieci, którzy chorują na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), taką jak rozedma płuc czy przewlekłe zapalenie oskrzeli lub inne choroby układu oddechowego cechujące się ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

### Środowisko użytkowania

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w szpitalu, klinice lub gabinecie lekarza a także w mieszkaniu oraz na zewnątrz w miejscach zadaszonych.

### WAŻNE

- Ze względów higienicznych każdy użytkownik powinien posiadać swój własny zestaw akcesoriów (pojemnik na lekarstwo, maskę, ustnik).
- Części takie jak ustnik i maski mogą być użyte ponownie po odpowiednich zabiegach dezynfekcyjnych (więcej informacji o dezynfekcji na str. 8).
- Inhalator jest urządzeniem medycznym. Należy stosować się do zaleceń lekarza w zakresie wyboru odpowiedniego typu leku i jego dawkowania.
- Specyfikacja nebulizacji różni się w zależności od zastosowanego leku. Tempo nebulizacji może być różne w zależności od użytego leku.
- Tak jak w przypadku każdego urządzenia mechanicznego, niniejszy produkt może być niezdolny do działania na skutek przerwy w dostawie energii elektrycznej, wyczerpania baterii lub usterki mechanicznej. Zalecamy posiadanie baterii do wymiany oraz możliwość dostępu do zapasowego urządzenia.

### OSTRZEŻENIE!

- **Nie stosować preparatów, zawierających hialuronian sodu i z wysoko stężonym chlorkiem sodu (od 3%).**
- **Nie stosować płynów zawierających ester, tłuste cząstki (w tym soku dyfuzyjnego i ekstraktu z ziół).**
- **Nie stosować olejków eterycznych.**

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu, przed użyciem proszę zapoznać się z instrukcją użycia.



### OSTRZEŻENIA

- Korzystanie z wyrobu nie zastępuje konsultacji medycznej, w przypadku wystąpienia dolegliwości zdrowotnych w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze swoim lekarzem.
- Zawsze należy przestrzegać wskazówek lekarza dotyczących rodzaju leku, który można stosować, jego dawki, częstotliwości i czasu trwania inhalacji.
- Stosować wyłącznie lekarstwo zalecone przez lekarza.
- W trakcie używania inhalatora zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad higieny.
- Pojemnika na lek nie wolno napełniać żadną cieczą, która nie została przepisana przez lekarza (z wyjątkiem soli fizjologicznej oraz płynu przeznaczonego do czyszczenia).
- Jeżeli po raz pierwszy od zakupu używasz inhalatora, lub nie był on używany przez długi czas, należy uprzednio wyczyścić jego części (więcej informacji na stronie 8).
- Po każdym użyciu należy wyczyścić pojemnik na lek, ustnik i maskę używając wody destylowanej (więcej informacji na stronie 8).
- Nie wolno podłączać i odłączać zasilacza sieciowego mokrymi dłońmi.

### UWAGA

- Jeżeli zauważysz brak wydobywającej się mgiełki z głowicy rozpylającej, natychmiast wyłącz urządzenie używając przycisku START/STOP, aby uniknąć uszkodzeniu siatki.
- Należy dokładnie oczyścić części inhalatora po każdym użyciu. W przeciwnym wypadku może nie działać prawidłowo.
- Zwykła woda z kranu nie jest środkiem przeznaczonym do użytku w inhalatorze. Nie wolno włączać urządzenia, gdy pojemnik na lek jest napełniony wodą. Tylko woda destylowana lub zdemineralizowana może być używana do czyszczenia pojemnika na lek.
- Nie wolno dopuszczać do kontaktu patyczków higienicznych, ani innych przedmiotów z siatką lub pojemnikiem na lek. Może to spowodować niewłaściwe działanie urządzenia.

- Chronić urządzenie przed silnym wstrząsem. Unikać narażania inhalatora na działanie sił zewnętrznych np. źródeł pola elektromagnetycznego lub wystawiać go na działanie dużej wilgotności. Mogą one spowodować niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia.
- Aby uniknąć nieprawidłowej pracy inhalatora spowodowanej zakłóceniami elektromagnetycznymi, nie należy używać urządzenia w pobliżu telefonu komórkowego i kuchenki mikrofalowej.
- Nie używać zasilacza sieciowego innego, niż przeznaczony dla tego produktu.
- Nie używać jednocześnie baterii różnego typu (różnych producentów).
- Nie przechowywać i nie przenosić inhalatora, jeśli zawiera on lek lub inną substancję.
- Nie zanurzać urządzenia głównego i zasilacza w wodzie.
- Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza (np. łazienka) lub gdy urządzenie główne lub przewód zasilający jest mokry.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jego niektóre niewielkie części mogą zostać połączony. Chronić dzieci przed dostępem do opakowania z urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przewidziane do użytku przez małe dzieci lub osoby ograniczone fizycznie lub umysłowo. Z urządzenia nie powinny korzystać osoby, które nie mają odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jak je bezpiecznie użytkować. Takie osoby mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych lub odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie należy przechowywać z daleka od źródeł ciepła.
- Nie używać wyrobu w pomieszczeniach, w których poprzednio był używany aerozol (np. lakier do włosów). Przed rozpoczęciem inhalacji należy przewietrzyć pomieszczenie.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscach chronionych przed niekorzystnym wpływem środowiska np. ekstremalnymi temperaturami, zanieczyszczeniem i kurzem, światłem słonecznym, upałem i zimnem.


## CECHY PRODUKTU

1. Kieszonkowy rozmiar, łatwy w przenoszeniu.
2. Niskie zużycie energii i niska objętość resztkowa leku (ilość leku, która zostaje po inhalacji).
3. Automatyczne wyłączenie urządzenie po 5 minutach pracy.

## OPIS ELEMENTÓW ZESTAWU


Opakowanie zawiera następujące elementy (rysunek poniżej). W przypadku braku któregośkolwiek z nich, należy niezwłocznie skontaktować się z wytwórcą. Bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie wyrobu jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy wykorzystywane są wraz z nim akcesoria zalecane przez wytwórcę.

### Główka rozpylająca z pojemnikiem na lek




1. Elektrody
2. Start/Stop
3. Wskaźnik pracy urządzenia
4. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
5. Klawisz PUSH (naciśnij)
6. Osłona gniazda zasilania
7. Pokrywa baterii


### Urządzenie główne



### Widok tyłu urządzenia



### Widok spodu urządzenia głównego



### Zasilacz




### Baterie alkaliczne




AA 1,5V x 2 szt.

### Etui



Maski i ustnik do inhalacji przeznaczone są do wielokrotnego użytku

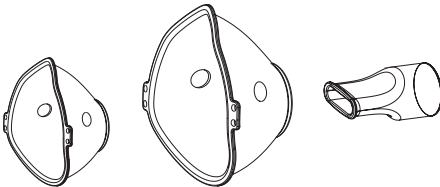

maska mała dla dzieci

maska duża dla dorosłych


ustnik

## CZĘŚCI I MATERIAŁY

Główka rozpylająca na lek	Poliwęglan
Ustnik	Polietylen
Maska dla dzieci/dorosłych	Polichlorek winylu
Obudowa urządzenia głównego	ABS

## JAK ZŁOŻYĆ INHALATOR

1. Przymocuj pojemnik na lek do urządzenia głównego




### UWAGA

- Należy upewnić się, że pojemnik na lek jest prawidłowo przymocowany; w przeciwnym razie połączenie i działanie inhalatora może być nieprawidłowe.
- Elektrody urządzenia głównego i pojemnik na lek należy utrzymywać w czystości, aby zapobiec niewłaściwemu działaniu inhalatora.

Przy prawidłowym założeniu pojemnika na lek usłyszysz charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

## 2. Przymocuj ustnik lub maskę

Należy szczelnie przymocować ustnik lub maskę do głowicy rozpylającej.

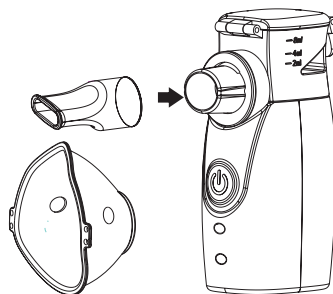


## JAK PODŁĄCZYĆ DO ŹRÓDŁA ZASILANIA


Inhalator może być zasilany bateriami lub zasilaczem sieciowym (opcjonalnie).

### 1. Zasilanie bateriami


1. Otwórz pokrywę na baterie



2. Włóż 2 baterie zwracając uwagę na odpowiednie ułożenie biegunów

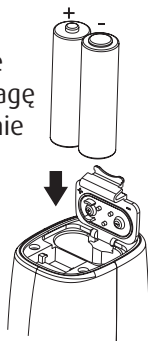


3. Zamknij pokrywę baterii



### 2. Żywotność i wymiana baterii (załączonych do zestawu)

- Do 30 min. w przypadku ciągłego użytkowania (6 nebulizacji po 5 minut), (2 baterie alkaliczne typu AA załączone do zestawu) lub 4 dni w przypadku użytkowania 3 razy dziennie, każdorazowo po 10 minut (2 nebulizacje po 5 minut).
- Jeśli wskaźnik niskiego poziomu baterii miga w kolorze pomarańczowym oznacza to, że baterie są niemal całkowicie wyczerpane, należy wymienić je na nowe.
- Jeśli wskaźnik niskiego poziomu baterii świeci ciągłym pomarańczowym światłem, oznacza to, że bardzo niski poziom baterii uniemożliwia działanie inhalatora. Należy wymienić baterie alkaliczne na nowe.

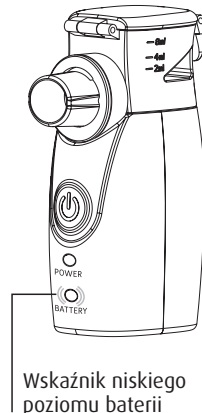


Wskaźnik niskiego poziomu baterii

### UWAGA


- Nie należy używać jednocześnie baterii różnego typu.
- **Żywotność baterii może się różnić w zależności od typu używanych baterii.**
- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterie nie mogą być ponownie ładowane, rozgrzewane lub wrzucane do ognia.
- Ciekące baterie mogą uszkodzić urządzenie. Jeżeli wyrób nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z urządzenia.
- Przy wymianie baterii należy upewnić się, czy pojemnik na lek jest całkowicie pusty, aby zapobiec ewentualnemu wylaniu lekarstwa.

### 3. Zasilanie przy użyciu zasilacza sieciowego

1. Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda ładowania urządzenia głównego.

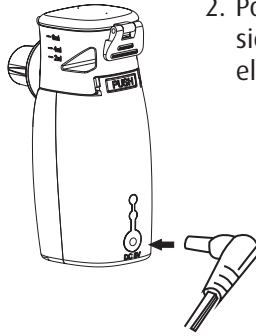

2. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

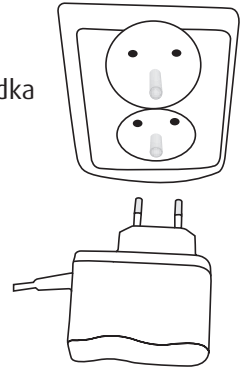

#### UWAGA


- Należy używać zasilacza sieciowego przeznaczonego wyłącznie dla tego urządzenia. Nie należy kupować i używać zasilaczy innych wytwórców.
- Po użyciu należy odłączyć zasilacz sieciowy. Nie należy pozostawiać go podłączonego do źródła zasilania przez długi czas.

### JAK NAPEŁNIĆ URZĄDZENIE LEKIEM

W pierwszej kolejności należy z głowicy rozpylającej zdjąć gumową nasadkę.

1. Naciśnij przycisk PUSH i zdejmij głowicę rozpylającą z pojemnikiem na lek z urządzenia głównego

Wciśnij przycisk PUSH znajdujący się na tylnej części urządzenia głównego i przesunij pojemnik na lek w stronę przedniej części urządzenia głównego.

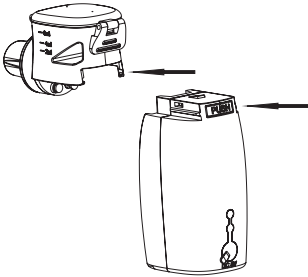

#### UWAGA


- W celu uniknięcia uszkodzenia inhalatora, należy upewnić się, że przycisk PUSH jest wciśnięty przed popchnięciem do przodu pojemnika na lek.
- W celu uniknięcia przerwania siatki, nie należy wywierać na nią nacisku przy użyciu palca lub innego przedmiotu.

2. Wlej lek do pojemnika na lek

- Otwórz pokrywę pojemnika na lek i napełnij lekiem. Zalecana objętość: 8 ml maksimum / 2 ml minimum.
- Należy zamknąć pokrywę pojemnika na lek.

#### UWAGA


- Aby zapobiec wyciekowi leku z pojemnika, należy upewnić się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.
- Proces napełniania lekiem powinien być wykonywany gdy pojemnik jest odłączony od urządzenia głównego.

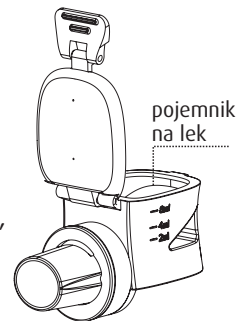



### 3. Przymocuj ponownie pojemnik na lek do urządzenia głównego

- Przymocuj pojemnik na lek; usłyszysz charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

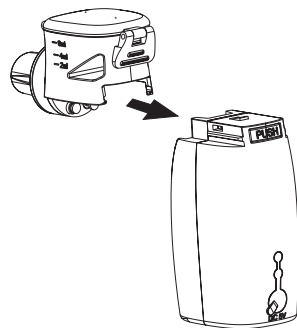


#### UWAGA

- Należy upewnić się, że pojemnik na lek jest prawidłowo przymocowany, aby zapobiec usterkom spowodowanym złym połączeniem.
- W celu zapewnienia prawidłowego działania inhalatora, elektrody urządzenia głównego i pojemnika na lek należy utrzymywać w czystości.

### 4. Przymocuj ustnik lub maskę

- Należy szczelnie przymocować ustnik lub odpowiednią maskę do głowicy rozpylającej urządzenia.



## JAK OBSŁUGIWAĆ INHALATOR

Po złożeniu urządzenia, można przed kolejnym użyciem przeprowadzić test prawidłowego funkcjonowania, napełniając pojemnik na lek 0,9% roztworem chlorku sodu (sól fizjologiczna) i wciskając przycisk START/STOP.


Jeśli inhalator nie rozpylił cieczy, należy zapoznać się z informacjami o rozwiązywaniu problemów na str. 12.

### 1. Włączanie zasilania

Wciśnij przycisk START/STOP, a wskaźnik POWER będzie świecił światłem ciągłym (kolor zielony), zaś pojemnik na lek będzie podświetlony na niebiesko.

#### UWAGA


1. Jeśli pojemnik na lek jest pusty, a zasilanie urządzenia jest włączone, to wskaźnik POWER będzie świecił przez około 0,5 sekundy (kolor zielony), a następnie zmieni kolor na pomarańczowy, po czym po ok. 8 sek. urządzenie automatycznie się wyłączy.
2. W czasie pracy urządzenia, gdy lek zostanie wykorzystany wskaźnik POWER od razu zmieni kolor na pomarańczowy a podświetlenie pojemnika na lek wyłączy się po czym urządzenie również zostanie automatycznie wyłączone.
3. Niektóre leki mogą spowodować, że urządzenie nie wyłączy się automatycznie. W takim wypadku, po zakończonej inhalacji, wyłącz nebulizator używając przycisku START/STOP, aby zapobiec uszkodzeniu siateczki.
4. Zwykła woda z kranu nie nadaje się do użytku w urządzeniu, ponieważ może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie inhalatora.

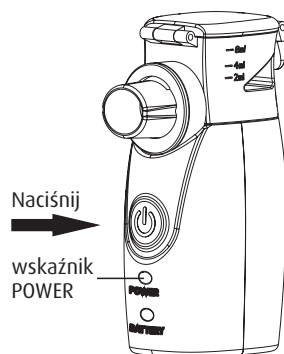

## 2. Inhalacja

Trzymaj stabilnie inhalator w dłoni i rozpocznij inhalację przy użyciu ustnika lub odpowiedniej maski.


**UWAGA: W przypadku wykrycia braku leku w pojemniku na lek, urządzenie ulegnie automatycznemu wyłączeniu.**



- Jeśli urządzenie nie wyłączy się automatycznie gdy skończy się lek, natychmiast wciśnij przycisk START/STOP w celu wyłączenia zasilania, aby zapobiec uszkodzeniu siateczki. Zapoznaj się z informacjami o rozwiązywaniu problemów na stronie 12.
- Podczas inhalacji urządzenie może być ułożone pod dowolnym kątem. Należy jednak upewnić się, że lek ma styczność z siatką. W przeciwnym wypadku inhalator ulegnie automatycznemu wyłączeniu po około 15 sekundach.
- Kiedy w pojemniku pozostanie niewiele leku, zaleca się przechylenie inhalatora do siebie, umożliwi to styczność pozostałego leku z siatką i dalszą inhalację.
- Podczas użytkowania nie należy potrząsać inhalatorem. Może to spowodować automatyczne wyłączenie urządzenia.
- Dzieci mogą korzystać z inhalatora wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Urządzenie ma wbudowany 5-minutowy automatyczny wyłącznik. Niezależnie od ilości leku pozostałego w pojemniku urządzenie po 5 minutach przerwie pracę. Aby kontynuować nebulizację należy wcisnąć przycisk START.

## 3. Wyłączanie zasilania

- Inhalator ulega automatycznemu wyłączeniu gdy skończy się lek, lub po 5 minutach pracy.
- Jeśli chcesz przerwać inhalację, należy wcisnąć przycisk START/STOP w celu wyłączenia zasilania. Zgaśnie wtedy wskaźnik POWER.
- Jeśli używany jest zasilacz sieciowy, należy odłączyć go z gniazdka po skończonej inhalacji.

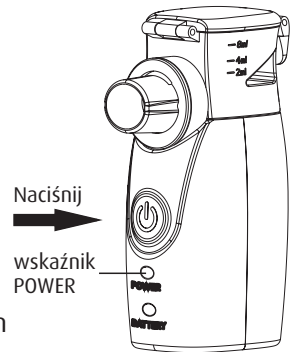

## CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCYJA

Przed pierwszym użyciem i niezwłocznie po każdorazowym użyciu urządzenia, należy je wyczyścić używając wody destylowanej lub zdemineralizowanej.

### 1. Tryb czyszczenia

- Odłącz pojemnik na lek od urządzenia głównego.
- Otwórz pokrywę pojemnika na lek i wylej pozostałości leku.
- Wlej do pojemnika na lek niewielką ilość wody destylowanej lub zdemineralizowanej (ok. 4 ml) i zamknij pokrywę.
- Energicznie potrząśnij pojemnikiem na lek ok. 10 sekund. Po tej czynności usuń wlaną wcześniej zawartość i ponownie uzupełnij 1 ml wody destylowanej/zdemineralizowanej.

- Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk START/STOP. **Wskaźnik POWER podświetli się na zielono i w tle będzie migać kolor pomarańczowy. Komora na lek podświetli się na niebiesko.** Pozostaw działający inhalator przez dwa cykle po 1 minucie w celu usunięcia resztek leku z pojemnika na lek lub do momentu wyczerpania zawartości.


#### UWAGA

- Jeśli urządzenie wydaje dźwięk o wysokiej częstotliwości po wyczerpaniu zawartości wody destylowanej lub zdemineralizowanej, należy wyłączyć urządzenie. W przeciwnym wypadku siatka może ulec uszkodzeniu.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić pozostałości leku. W przeciwnym wypadku siatka może ulec zatkanie.

#### ⚠ Dodatkowe czyszczenie głowicy inhalatora:


W przypadku całkowitego lub częściowego zatkania siateczki (mgiełka będzie mniejsza lub nie będzie jej zupełnie), zalecamy wyczyścić głowicę przy użyciu roztworu wody z octem (10%). Przygotowanie roztworu: do 1 części octu spożywczego 10% dodać 4 części przegotowanej wody. Tak przygotowany roztwór należy wlać bezpośrednio na siateczkę od strony ustnika (rys. obok). Po 10 minutach wylać roztwór i wlać jeszcze raz roztwór wody z octem (2 ml) tym razem bezpośrednio do głowicy.

Uruchomić inhalator i pozostawić działający do momentu wyczerpania zawartości lub do momentu automatycznego wyłączenia się urządzenia. Inhalator powinien wyłączyć się automatycznie po wyczerpaniu zawartości płynu. Po czyszczeniu głowicy roztworem z octem zalecamy przeprowadzić ponowne czyszczenie wodą zdemineralizowaną opisaną w punkcie 1.



## 2. Rozmontuj inhalator

Odłącz głowicę rozpylającą z pojemnikiem na lek a także maskę lub ustnik. Niezwłocznie po każdorazowym użyciu należy oczyścić maski i ustnik używając wody destylowanej, mineralnej, lub wody przegotowanej a następnie należy je wysuszyć. Akcesoria mogą być użyte ponownie po odpowiednich zabiegach dezynfekcyjnych (zapoznaj się z informacjami o dezynfekcji na stronie 10). Jeżeli maski bądź ustnik ulegną uszkodzeniu należy wymienić je na nowe.




## 3. Dokładnie wysusz czyszczone części

Po czyszczeniu, należy dokładnie wysuszyć części używając gazy i pozostawiając je do całkowitego wyschnięcia.

#### UWAGA

- Nie należy suszyć szmatkami z bawełny lub innych materiałów; ponieważ kurz lub drobiny tkaniny mogą pozostać na siatce, powodując nieprawidłowe działanie urządzenia
- Nie należy dopuszczać do kontaktu patyczków higienicznych ani innych przedmiotów z siatką pojemnika na lek.




#### 4. Wytrzyj urządzenie główne używając gazy

Zwilż gazę wodą i delikatnie zmyj zanieczyszczenia z urządzenia głównego. Następnie użyj nowej gazy w celu wysuszenia urządzenia. Należy wyczyścić patyczkiem higienicznym elektrody, co zapewni prawidłowe przewodnictwo elektryczne. Wszystkie części należy przechowywać w czystym miejscu.




#### 5. Dezynfekcja

W przypadku chorób zakaźnych ustnik i maski należy dezynfekować lub sterylizować po każdym użyciu. Można także używać alkoholu lub innych powszechnie dostępnych aerozoli dezynfekcyjnych na bazie alkoholu. Należy upewnić się, że na komponentach nie ma pozostałości substancji dezynfekującej, w celu zapewnienia bezpiecznej inhalacji przy następnym użyciu.



- Zdezynfekuj ustnik i maski wygotowując je przez 3 minuty w wodzie o temp. 100°C.
- Pojemnika na lek nie należy gotować, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.



- Dokładnie wysusz części urządzenia.

### JAK WYMIENIĆ POJEMNIK NA LEK

Pojemnik na lek jest częścią wymienną. W normalnych warunkach jego żywotność wynosi około 6 miesięcy (przy użytkowaniu 3x dziennie po 15 minut. Jednakże, wydajność inhalacyjna może zacząć spadać po czasie krótszym niż 6 miesięcy, w zależności od sposobu użytkowania i rodzajów leków. Jeśli inhalator nie działa prawidłowo, lub tempo nebulizacji znacząco spadło, pojemnik na lek należy wymienić na nowy.

#### 1. Zdejmij pojemnik na lek z urządzenia głównego


Wciśnij przycisk PUSH znajdujący się na tylnej części urządzenia głównego i przesuń pojemnik na lek w stronę przedniej części urządzenia głównego.

#### 2. Przymocuj ponownie pojemnik na lek do urządzenia głównego

Przymocuj prawidłowo nowy pojemnik na lek.

#### UWAGA

- Należy upewnić się, że pojemnik na lek jest prawidłowo przymocowany, aby zapobiec usterkom spowodowanym złym połączeniem i nieprawidłowym działaniem.
- Przed użyciem należy wyczyścić pojemnik na lek.

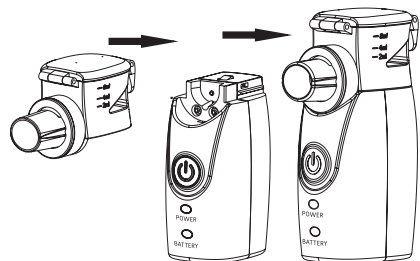

## JAK PRZECHOWYWAĆ INHALATOR I AKCESORIA

Aby prawidłowo odłączyć akcesoria należy postępować zgodnie z poniższymi krokami. Następnie należy umieścić je w etui do przenoszenia.

### 1. Rozmontuj inhalator


Należy odłączyć ustnik lub maskę inhalacyjną.

### 2. Załóż nasadkę na głowicę rozpylającą

Należy założyć nasadkę, aby ochronić inhalator przed możliwym uszkodzeniem podczas transportu.

### 3. Umieść inhalator i akcesoria w etui do przenoszenia

- Nie należy przenosić inhalatora, jeśli w pojemniku na lek znajduje się lek lub woda. Lek może wyciec, powodując uszkodzenie inhalatora.
- Nie należy przechowywać inhalatora w miejscu o wysokiej temperaturze, wilgotności, ani narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Jeżeli inhalator nie będzie użytkowany przez dłuższy czas należy wyjąć baterie.

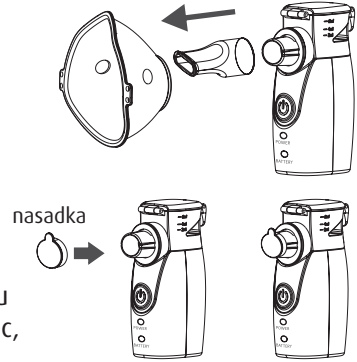

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W celu rozwiązania problemów, które mogą pojawić się podczas użytkowania inhalatora, należy zapoznać się z poniższą tabelą.

PROBLEMY	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Bardzo mała ilość mgiełki wydobywająca się z inhalatora lub brak mgiełki.	Pojemnik na lek nie jest odpowiednio przymocowany.	Ponownie przymocuj pojemnik na lek w prawidłowy sposób i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 4)
	Brak styczności leku z siatką przez ponad 15 sekund.	Przechyl odpowiednio urządzenie, aby umożliwić styczność leku z siatką.
	Siatka pojemnika na lek jest zapchana.	Wyczyść pojemnik na lek (str. 8). Jeśli po czyszczeniu urządzenie nadal nie działa prawidłowo, pojemnik na lek należy wymienić na nowy (str. 10)
	Elektrody pojemnika na lek są zanieczyszczone lekiem lub wodą.	Oczyść elektrody z leku lub wody i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 9)
	Kondensacja pary wodnej na siatce.	Wyłącz urządzenie i odczekaj kilka minut.
Po włączeniu zasilania wskaźnik POWER świeci przez sekundę, następnie gaśnie.	Pojemnik na lek nie jest odpowiednio przymocowany.	Ponownie przymocuj pojemnik na lek w prawidłowy sposób i uruchom ponownie urządzenie. (więcej informacji na str. 4)
	Brak leku w pojemniku na lek.	Napełnij pojemnik na lek. (więcej informacji na str. 6)
	Brak styczności leku z siatką.	Przechyl odpowiednio urządzenie, aby umożliwić styczność leku z siatką (więcej informacji na str. 8)
	Elektrody pojemnika na lek są zanieczyszczone lekiem lub wodą.	Oczyść elektrody z leku lub wody i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 9)

PROBLEMY	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Wskaźnik POWER nie świeci się i inhalator nie działa.	Baterie są włożone w nieprawidłowy sposób.	Włóż baterie ponownie zwracając uwagę na ułożenie biegunów i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 5)
	Niski poziom baterii.	Wymień baterie na nowe i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 5)
	Zasilacz sieciowy podłączony jest do inhalatora w nieprawidłowy sposób.	Podłącz zasilacz ponownie w odpowiedni sposób i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 6)
Wskaźnik POWER świeci a inhalator nie działa.	Wskaźnik niskiego poziomu baterii BATTERY świeci pomarańczowym światłem ciągłym, niewystarczająca moc baterii, lub baterie się wyczerpały.	Wymień baterie na nowe i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 5)
	Przerwanie siatki pojemnika na lek.	Wymień pojemnik na lek na nowy, następnie napełnij go lekiem (więcej informacji na str. 10)
	Elektrody pojemnika na lek są zanieczyszczone lekiem lub wodą.	Oczyść elektrody z leku lub wody i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 9)
	Siatka pojemnika na lek jest zapchana.	Jeśli po czyszczeniu urządzenie nadal nie działa prawidłowo, pojemnik na lek należy wymienić na nowy (więcej informacji na str. 10)
	Kondensacja pary wodnej na siatce.	Wyłącz urządzenie i odczekaj kilka minut.

PROBLEMY	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Inhalator wyłącza się w trakcie używania. (poniżej 5 minut)	Pojemnik na lek jest nieprawidłowo przymocowany.	Ponownie przymocuj pojemnik na lek w prawidłowy sposób i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 4)
	Wtyczka łącząca zasilacz sieciowy z inhalatorem jest nieprawidłowo założona.	Podłącz ponownie w odpowiedni sposób i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 6)
	Skończył się lek.	Napełnij pojemnik na lek (więcej informacji na str. 6)
	Brak styczności leku z siatką przez ponad 15 sekund.	Przechyl odpowiednio urządzenie, aby umożliwić styczność leku z siatką (więcej informacji na str. 8)
Inhalator nie wyłącza się automatycznie gdy skończy się lek.	Inhalator w trakcie użytkowania jest poddany gwałtownym wstrząsom.	Trzymaj inhalator stabilnie w dłoni
	Pojemnik na lek jest uszkodzony.	Wymień pojemnik na lek na nowy, następnie napełnij go lekiem (więcej informacji na str. 10)
	Pewne typy leków do nebulizacji mogą powodować powstawanie dużej ilości piany w pojemniku na lek.	Wyczyść pojemnik z piany i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 8)
	Elektrody pojemnika na lek są zanieczyszczone lekiem lub wodą.	Oczyść elektrody z leku lub wody i uruchom ponownie urządzenie (więcej informacji na str. 9)
Wyciek leku z pojemnika na lek.	Pęknięcie pojemnika na lek lub silikonowej uszczelki.	Wymień pojemnik na lek na nowy (więcej informacji na str. 10)

Jeśli Państwa inhalator nie działa prawidłowo po zastosowaniu powyższych rozwiązań, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wytwórcą produktu. Infolinia 800 70 30 11 lub 85 874 60 45, 85 874 69 28 (w godz. 8-16)




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Model</b>	Diagnostic PRO MESH
<b>Wymiary</b>	ok. 72 mm (dł.) × 40 mm (szer.) × 113 mm (wys.)
<b>Waga</b>	ok. 98 g (bez baterii)
<b>Źródło zasilania</b>	3V DC (2 baterie alkaliczne "AA" 1,5V) Zasilacz sieciowy: Wejście: 100–240V AC, 50/60Hz, 0,2A Wyjście: 5V DC, 1A
<b>Zużycie mocy</b>	ok. 1,2 W
<b>Częstotliwość wibracji</b>	ok. 113 kHz
<b>Szybkość nebulizacji</b>	minimalnie >0.25 ml/min
<b>Poziom hałasu</b>	<50 dB (w odległości 1 m)
<b>Rozmiar cząsteczki</b>	MMAD 3,8 µm
<b>Zalecana objętość leku</b>	Maksymalnie: 8 ml, Minimalnie: 2 ml
<b>Żywotność baterii</b>	Żywotność baterii dołączonych do zestawu – do 30 min. (6 nebulizacji po 5 minut) lub 4 dni przy użytkowaniu 3 x dziennie przez 10 minut (2 nebulizacje po 5 minut).
<b>Czas życia wyrobu</b>	Urządzenie główne: 3 lata Pojemnik na lek: 6 miesięcy Okresy trwałości wynoszą jak powyżej przy zapewnieniu, że produkt jest użytkowany do nebulizacji soli fizjologicznej 3 razy dziennie każdorazowo przez 15 minut (3 x 5 minut) w temperaturze pokojowej (23°C). Okres przydatności może różnić się w zależności od środowiska użytkowania. W przypadku uszkodzenia masek lub ustnika należy niezwłocznie wymienić na nowe.
<b>Działanie w dowolnym położeniu</b>	Do góry dnem lub przekrzywiony działa do 15 sekund
<b>Wykrywanie braku leku w zbiorniku</b>	Pomarańczowy wskaźnik LED (POWER) włącza się na 8 sek., następnie zasilanie jest odłączane.
<b>Automatyczne wyłączenie</b>	Inhalator wydaje dźwięk o wysokiej częstotliwości i wyłącza się automatycznie w przypadku braku styczności leku z siatką przez ponad 15 sekund (czas ten różni się w zależności od typu leku) lub gdy skończy się lek. Ma to na celu zapobieganie uszkodzeniu siatki.
<b>Warunki użytkowania</b>	Temperatura: 10–40°C (50–104°F); Wilgotność: 15–93% R.H. Ciśnienie atmosferyczne: 800–1060 hPa
<b>Warunki przechowywania i transportu</b>	Temperatura: –2–70°C (–4–158°F); Wilgotność: ≤93% R.H. Ciśnienie atmosferyczne: 800–1060 hPa
<b>Zawartość opakowania</b>	Urządzenie główne, nasadka na głowicę rozpylającą, ustnik, maska dla dzieci, maska dla dorosłych, głowica rozpylająca z pojemnikiem na lek, baterie alkaliczne, etui, instrukcja użycia, zasilacz sieciowy

Producent zastrzega możliwość zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia.

## WYKAZ WIELKOŚCI CZĄSTECZEK ROZPYLANYCH PRZEZ INHALATOR zgodny z normą EN 13544-1

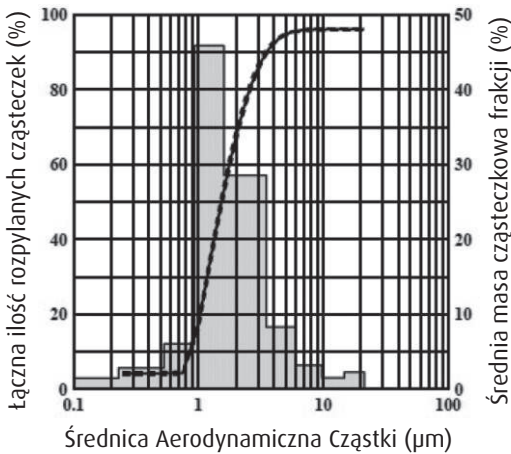


Dane ulegają zmianie w zależności od stosowanego leku. Pomiar wykonano z użyciem technologii dyfrakcji laserowej i roztworu fizjologicznego. Dostarczone dane mogą nie mieć zastosowania do leków w zawiesinie lub leków o dużej lepkości. Należy zwrócić się do producenta leku.

## AKCESORIA / CZĘŚCI WYMIENNE

W celu zamówienia poniższych akcesoriów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wytwórcą produktu.


1. Głowica rozpylająca z pojemnikiem na lek



2. Ustnik



3. Maski do inhalacji wielokrotnego użytku

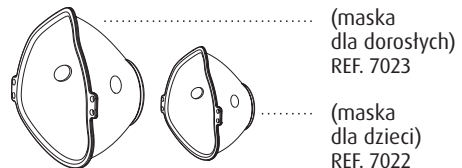














## UWAGA

Urządzenie zostało przetestowane i sklasyfikowane jako spełniające wymagania norm dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 wytycznych FCC. Wymagania te służą zapewnieniu właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie może generować, używać i emitować energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnego z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnych instalacjach. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia sygnału radiowego lub telewizyjnego, które można stwierdzić poprzez jego wyłączenie i włączenie, należy podjąć próbę zapobiegnięcia dalszym zakłóceniom przez zastosowanie jednego lub więcej następujących kroków:

- Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

## WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Ważne ostrzeżenia		Rok produkcji		Wytwórca
	Izolacja klasy II		Urządzenie Typ BF		Numer seryjny
	Prąd stały		Zapoznaj się z instrukcją użycia		Data ostatniej aktualizacji
<b>IP22</b>	Stopień ochrony		Chronić przed wilgocią		Polaryzacja wtyczki zasilacza
	Numer katalogowy		Chronić przed światłem słonecznym		



Zużyty wyrób oraz baterie oddać do punktu zbiórki odpadów. Zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Jeśli masz wątpliwości, gdzie oddać zużyty aparat skontaktuj się z firmą Diagnosis.

## Kompatybilność elektromagnetyczna

### Wskazówki i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne

Urządzenia są przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku.

Test emisji	Spełnianie wymagań	Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego
Emisja fal o częstotliwości radiowej; norma CISPR 11	Grupa 1	Urządzenie wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej tylko do swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym te emisje są bardzo niskie i nie powinny powodować zakłóceń pracy sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu.
Emisja fal o częstotliwości radiowej; norma CISPR 11	Klasa B	Urządzenie może być używane we wszystkich budynkach, łącznie z mieszkalnymi oraz budynkami, które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	nie dotyczy	
Wahania napięcia / emisje migotania IEC 61000-3-3		

**Wskazówki i oświadczenie wytwórcy dotyczące odporności elektromagnetycznej.**

URZĄDZENIE jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym wyszczególnionym poniżej. Nabywca lub użytkownik URZĄDZENIA powinien zapewnić, że będzie ono używane w takim środowisku.


Test odporności	Poziom testowy, norma IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne – wskazówki
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV rozładowanie dotykowe ± 8 kV rozładowanie powietrzne	± 6 kV rozładowanie dotykowe ± 8 kV rozładowanie powietrzne	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%. Jeżeli ESD zakłóca działanie urządzenia, należy rozważyć wykorzystanie elementów przeciwdziałających tj. paska na nadgarstek, uziemienia.
Stany przejściowe i impulsy zgodnie z IEC 61000-4-5	± 2 kV dla linii zasilających ± 1 kV dla linii wejścia/wyjścia	Nie dotyczy	Jakość zasilania powinna być taka, jak dla typowych instalacji handlowych czy szpitalnych.
Skoki napięcia IEC 61000-4-5	± 1 kV tryb różnicowy ± 2 kV tryb współbieżny	Nie dotyczy	Jakość zasilania powinna być taka, jak dla typowych instalacji handlowych czy szpitalnych.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściach linii zasilania IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% zapad napięcia UT) przez 0,5 cyklu 40% UT (60% zapad napięcia UT) przez 5 cykli 70% UT (30% zapad napięcia UT) przez 25 cykli <5% UT (>95% zapad napięcia UT) przez 5 s	Nie dotyczy	Jakość zasilania powinna być taka, jak dla typowych instalacji handlowych czy szpitalnych. Jeśli użytkownik URZĄDZENIA wymaga ciągłego zasilania podczas przerw w dostawie głównej sieci zasilającej, zaleca się, aby URZĄDZENIE było zasilane z zasilacza UPS lub baterii.
Pole magnetyczne zasilania o częstotliwości (50/60Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Poziom pól magnetycznych źródeł zasilania powinien mieścić się w granicach obowiązujących dla typowych instalacji handlowych lub szpitalnych.

Uwaga UT jest zmiennym napięciem (AC) sieci energetycznej przed zastosowaniem poziomu testującego.

RF – częstotliwość z odcinka spektrum elektromagnetycznego, która jest pomiędzy dolnym zakresem częstotliwości radiowych fal długich a zakresem podczerwieni; częstotliwość użyteczna do transmisji radiowej. Za granice ogólnie przyjmuje się 9 kHz i 3 000 GHz.

**Wskazówki i oświadczenie wytwórcy dotyczące odporności elektromagnetycznej**

URZĄDZENIE jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik URZĄDZENIA powinien upewnić się, że pracuje ono w takim właśnie środowisku.

Test odporności	Poziom testowy, norma IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne – wskazówki
			Przenośne urządzenia do komunikacji bezprzewodowej oraz telefony komórkowe nie powinny być używane w mniejszej odległości od URZĄDZENIA, w tym również okablowania, niż zalecany minimalny dystans wyliczony z równań stosowanych do częstotliwości pracy nadajnika. Zalecany minimalny dystans:
Zaburzenia elektromagnetyczne w zakresie przewodzone RF zgodnie z IEC 61000-4-6	3 Vrms 26 kHz do 80 MHz	3 Vrms	$d = 1,2\sqrt{P}$
Emitowany sygnał o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-3	3 Vrms 80 MHz do 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz do 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz do 2,5 GHz
			gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach [W] podaną przez producenta, a d zalecaną minimalną odległością w metrach [m]. Moc zaburzeń elektromagnetycznych pochodzących ze stałych nadajników fal RF, ustalonych w warunkach miejscowych (a), powinna być niższa niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości (b). Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: 
<b>Uwaga 1:</b> dla 80 MHz i 800 MHz przyjmuje się wyższy zakres częstotliwości.			
<b>Uwaga 2:</b> podane informacje nie stosują się w każdej sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych mają wpływ absorpcja i odbicia od powierzchni, obiektów oraz osób.			
(a) Moce pól pochodzących od określonych nadajników takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej, przekaźniki radiowe, radio amatorskie, transmisja radiowa na falach AM i FM oraz transmisja TV nie dają się teoretycznie przewidzieć z dokładnością. Aby oszacować środowisko elektromagnetyczne należy rozważyć badanie warunków miejscowych. Jeśli zmierzona moc pola w miejscu gdzie pracuje URZĄDZENIE przekracza odpowiedni poziom zgodności, powinno sprawdzać się czy URZĄDZENIE pracuje normalnie. Jeśli zaobserwuje się niewłaściwą pracę, może okazać się niezbędne poczynić odpowiednie kroki zapobiegawcze takie jak przestawienie bądź przeniesienie URZĄDZENIA.			
(b) Dla częstotliwości spoza zakresu 150 kHz do 80 MHz, moc pola nie powinna być większa niż 3 V/m.			
RF – częstotliwość z odcinka spektrum elektromagnetycznego, która jest pomiędzy dolnym zakresem częstotliwości radiowych fal długich, a zakresem podczerwieni; częstotliwość użyteczna do transmisji radiowej. Za granice ogólnie przyjmuje się 9 kHz i 3 000 GHz			

## Zalecane odstęp między przenośnym a mobilnym sprzętem komunikacji radiowej oraz URZĄDZENIEM

URZĄDZENIE jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym, w którym zaburzenia elektromagnetyczne RF są kontrolowane. Odbiorca bądź użytkownik URZĄDZENIA może zapobiegać interferencji elektromagnetycznej poprzez zachowywanie minimalnego dystansu między przenośnymi urządzeniami do komunikacji bezprzewodowej (nadajnikami) a URZĄDZENIEM zalecanego poniżej, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową urządzeń komunikacyjnych.

Maksymalna moc znamionowa nadajnika [W]	Odstęp zgodnie z częstotliwością nadajnika [m]		
	150 kHz do 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz do 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz do 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,12	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23


Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej niewyróżnionej powyżej, zalecany minimalny dystans  $d$  w metrach [m] może być oszacowany przy użyciu równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie  $P$  jest podaną przez producenta nadajnika jego mocą maksymalną w watach [W].

**Uwaga 1:** Przy 80MHz i 800MHz przyjmuje się wyższy zakres częstotliwości.

**Uwaga 2:** Podane informacje nie stosują się w każdej sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych mają wpływ absorpcja i odbicia od powierzchni, obiektów oraz osób.

## ADNOTACJE PUNKTU SERWISOWEGO

L.p.	data zgłoszenia	data naprawy	gwarancję przedłużono do	opis czynności	pieczętka i podpis wykonawcy

 DIAGNOSIS S.A.  
ul. Gen. W. Andersa 38A,  
15-113 Białystok, Polska  
www.diagnosis.pl

SERWIS GŁÓWNY  
DIAGNOSIS S.A.  
ul. Przemysłowa 8, 16-010 Wasilków  
tel. 85 874 60 45  
serwis@diagnosis.pl



pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

## KARTA GWARANCYJNA

NAZWA URZĄDZENIA.....

MODEL .....

NUMER FABRYCZNY .....

DATA SPRZEDAŻY .....

### WARUNKI GWARANCJI

1. Diagnosis S.A. udziela gwarancji:

- 24 miesiące na Inhalator Diagnostic PRO MESH
- Głowica rozpylająca z pojemnikiem na lek objęta jest 6 miesięczną gwarancją
- Wymienne części takie jak: ustnik i maski nie są objęte gwarancją.

Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni. Termin liczy się od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu.

2. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku, gdy:

- naprawa nie została wykonana w terminie określonym w punkcie 1
- uprawniony punkt serwisowy stwierdził wadę fabryczną nie możliwą do usunięcia
- w okresie gwarancji wykonane zostały 4 naprawy, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzętu.

3. Gwarancją nie są objęte: baterie, wyroby z nieczytelnym lub zniszczonym numerem fabrycznym, uszkodzenia powstałe w skutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika i przechowywania, dostanie się do wnętrza płynów lub ciał obcych, przepięć w sieci zasilającej, naprawy przez osoby niepowołane oraz zdarzeń losowych.

4. Wadliwy sprzęt nabywca powinien dostarczyć na adres serwisu głównego.

5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

6. Jediną podstawą uprawnień gwarancyjnych jest karta gwarancyjna z wpisaną datą sprzedaży, pieczętką i podpisem sprzedawcy. Karta niewypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek i wpisów przez osoby nieupoważnione, nieczytelna w skutek zniszczenia – jest nieważna.

**UWAGA!** Przed wysyłką urządzenia do naprawy prosimy o uprzednie jego wyczyszczenie z wszelkiego rodzaju zabrudzeń.

**WYTWÓRCA:**

Diagnosis S.A.  
ul. Gen. W. Andersa 38A  
15-113 Białystok, Polska  
[www.diagnosis.pl](http://www.diagnosis.pl)

**INFOLINIA**

**800 70 30 11**

dla telefonów stacjonarnych  
połączenie bezpłatne

**+48 85 874 69 28**

dla telefonów komórkowych  
(koszt połączenia ponosi dzwoniący  
zgodnie z taryfą operatora)

**SERWIS GŁÓWNY**

Diagnosis S.A.  
ul. Przemysłowa 8,  
16-010 Wasilków  
tel. 85 874 60 45  
[serwis@diagnosis.pl](mailto:serwis@diagnosis.pl)